

Dissecteur ultrasonique sans fil à mâchoires courbées Sonicision<sup>MC</sup> 7

## Liberté sans fil. Moins de déchets<sup>1,†</sup>.



Le générateur autoclavable et réutilisable avec transducteur intégré peut être utilisé lors de

150  
interventions

avant que vous ayez à le remplacer<sup>2</sup>.



Le transducteur du dispositif Harmonic Ace<sup>MC\*</sup> +7 Shears avec hémostase avancée ne peut être utilisé que 95 fois

avant qu'il doive être remplacé<sup>3</sup>.




Les dispositifs Harmonic<sup>MC\*</sup> HD1000i Shears et 1100 Shears et leurs transducteurs intégrés sont à usage unique — nécessitant à être remplacés après chaque intervention<sup>4,5</sup>.



Le transducteur du dispositif Thunderbeat<sup>MC\*</sup> Front-Actuated Grip Type S ne peut être utilisé que 100 fois avant qu'il doive être remplacé<sup>6</sup>.

†Comparaison de masse faite avec le dissecteur et l'outil d'assemblage.

# La liberté d'en faire plus<sup>7,†,‡</sup> – avec moins de déchets<sup>1,§</sup>.

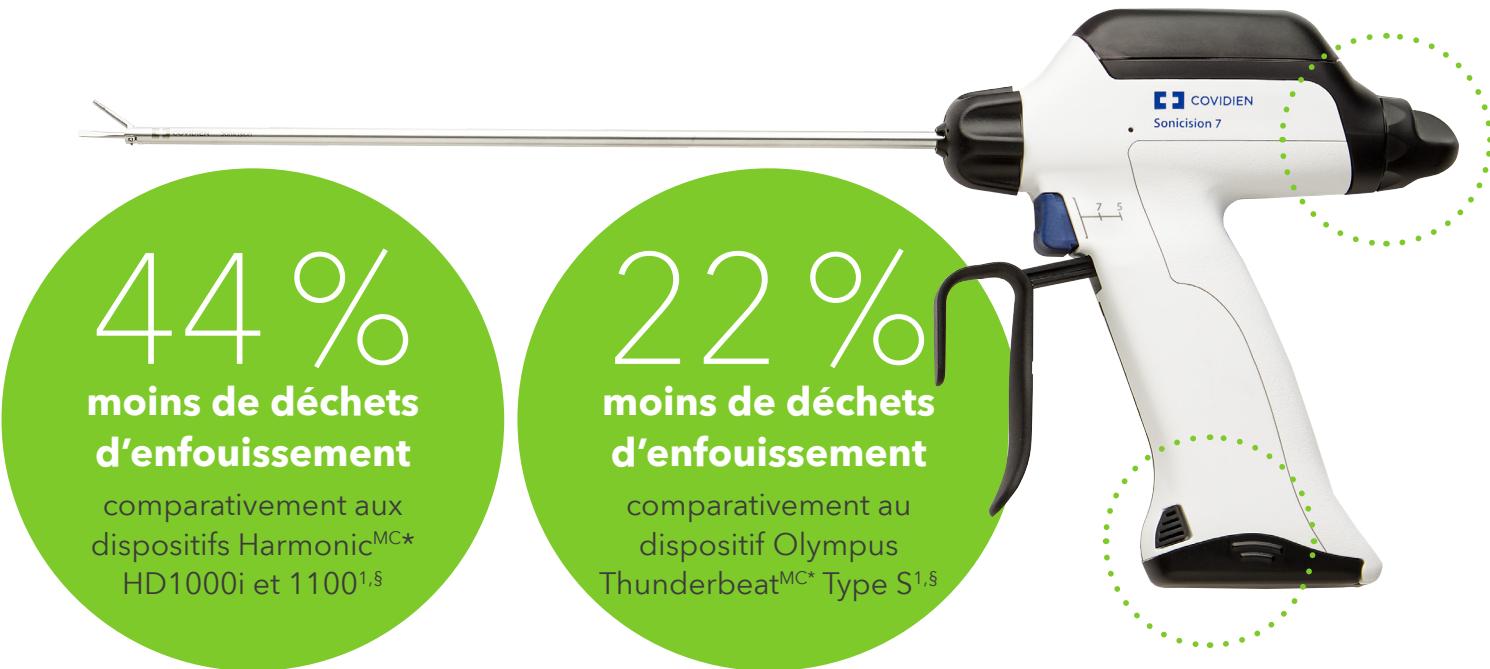

Le bloc-pile réutilisable peut être utilisé lors de

**200 interventions**

avant qu'il doive être remplacé<sup>8,9</sup>.

Programmes de recyclage offerts dans certaines régions

**Communiquez avec votre représentant des ventes de Medtronic dès aujourd'hui.**

© 2024 Medtronic. Tous droits réservés.  
Medtronic, le logo de Medtronic et « Concevoir l'extraordinaire » sont des marques de commerce de Medtronic. <sup>MC\*</sup>Les marques de tiers sont des marques de commerce de leurs détenteurs respectifs. Toutes les autres marques sont des marques de commerce d'une société de Medtronic. CA-OR-0021-F Rév. 01/2024

99, rue Hereford  
Brampton (Ontario) L6Y 0R3  
Numéro sans frais : 800 268 5346  
Tél. : 905 460 3800  
[medtronic.ca](http://medtronic.ca)

**Medtronic**

†25 chirurgiens sur 27 interrogés après l'utilisation du produit étaient d'accord.

‡26 chirurgiens sur 27 interrogés après l'utilisation du produit étaient d'accord. Par rapport au dispositif à mâchoires courbées SonicationMC.

§Comparaison de masse faite avec le dissecteur et l'outil d'assemblage. Générateur et bloc-pile du Sonication<sup>MC</sup> 7 non inclus.

#### Références :

1. Selon le rapport de test interne no RE00439207 rev A, Soni comparison report. 8 décembre 2022.
2. Selon le rapport de test interne no RE00108733, rév. A, portant sur la vérification de la durée de vie du bloc-pile réutilisable, Project Sabre. Août 2017.
3. Harmonic<sup>TM\*</sup> Gray Hand Piece and Gray Test Tip [mode d'emploi]. Guaynabo, PR: Ethicon Endo-Surgery; 2020.
4. Harmonic<sup>MC\*</sup> 1100 Shears [résumé de l'analyse de la valeur]. Ethicon; 2022.
5. Harmonic<sup>MC\*</sup> HD1000i Shears [brochure de vente]. Cincinnati, OH: Ethicon Endo-Surgery, Inc.; 2018.
6. Thunderbeat<sup>MC\*</sup> System Reference Guide [résumé du mode d'emploi]. Southborough, MA: Olympus America Inc.; 2014.
7. Selon le rapport de test interne no RE00329878, rév. A, portant sur l'évaluation de l'expérience des chirurgiens avec le dissecteur ultrasonique sans fil à mâchoires courbées SonicationMC 7 aux fins de commercialisation. Les 14 et 15 avril et du 20 au 22 avril 2021.
8. Selon le rapport de test interne no RE00113195, rév. A, portant sur la vérification de la durée de vie du bloc-pile réutilisable du SCBA - Oxivir. 13 septembre 2017.
9. Selon le rapport de test interne no R0042707, rév. A, portant sur la vérification de la durée de vie du bloc-pile réutilisable du SCBA. 26 avril 2017.