


Preguntas que quizás quiera plantearle a su médico cuando le recomiende un dispositivo cardíaco (DAI o TRC-D)




- ¿Por qué necesito un dispositivo cardíaco?
- ¿Qué alternativas tengo aparte del implante?
- ¿No podría controlar la enfermedad con medicamentos?
- ¿Cómo funciona el dispositivo cardíaco?
- ¿Dónde se colocará el dispositivo?
- ¿Cómo se implantará?
 - ¿Debajo de la piel o debajo del músculo?
- ¿Qué aspecto tendrá la cicatriz cuando se cure?
- Después del implante, ¿se moverá el dispositivo?
- ¿Qué restricciones debo respetar después del implante y durante cuánto tiempo?
- Después del implante y la recuperación, ¿puedo volver a hacer ejercicio?
- ¿Cuándo podré volver a tener relaciones íntimas con mi pareja?
- ¿Afectará el implante a mi vida profesional o a mis aficiones?

(Anote actividades laborales o aficiones sobre las que quiera consultar al médico. Por ejemplo: conducir una carretilla elevadora o trabajar cerca de maquinaria, aficiones o actividades como nadar, practicar golf o tenis, cazar, soldar, etc.).
- ¿Podré sentir cuándo funciona el dispositivo?
 - ¿Notaré la estimulación?
 - ¿Notaré descargas?
 - ¿Qué se siente cuando se produce una descarga?

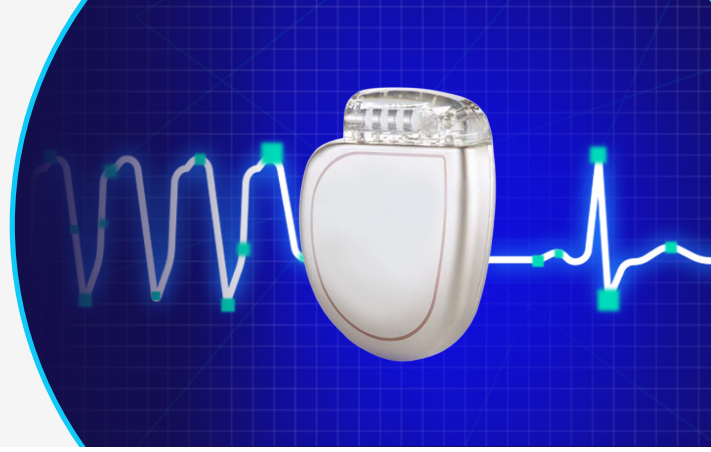

Preguntas que quizás quiera plantearle a su médico cuando le recomiende un dispositivo cardíaco (DAI o TRC-D)

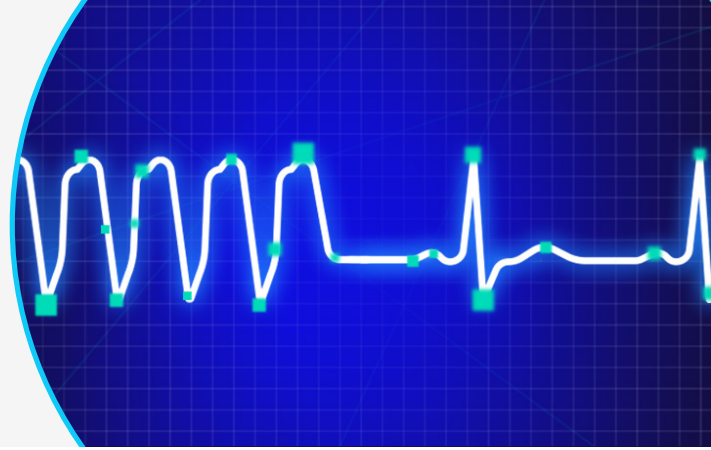

- Desarrolle un plan en caso de descargas junto con el médico preguntándole lo siguiente:**
 - ¿Qué debo hacer si recibo una descarga?
 - ¿Y si recibo varias?
 - Si alguien me toca durante una descarga, ¿la notará o podrá resultar herido?
- ¿Tengo que ponerme en contacto con el centro médico si, tras caerme o recibir un golpe en el dispositivo, siento dolor?**
- ¿Cuánto tiempo durará la batería del dispositivo y cómo sabré cuándo hay que cambiarla?**
- En lo sucesivo, ¿se me podrán realizar exploraciones por resonancia magnética?**
- Después de la intervención, ¿puedo estar en un aeropuerto o viajar en avión de forma segura?**
- ¿Qué clase de artículos domésticos pueden interferir con el dispositivo y qué precauciones debo tomar?**
- ¿Puedo estar cerca de imanes comunes?**
 - ¿Qué pasa si estoy demasiado cerca de un imán y el dispositivo emite un sonido?
- ¿Podría enseñarme un ejemplo de los sonidos que podría emitir el dispositivo?**
 - ¿Qué significan los diferentes sonidos?
 - ¿Qué debo hacer cuando escuche cada uno de ellos?
- En mi caso, ¿sería viable la monitorización remota?**
- ¿Cómo funciona la monitorización remota?**
 - ¿Hay algo en particular que deba hacer?, ¿o funciona sin mi intervención?
- ¿De qué recursos dispongo si me surgen más preguntas?**

Esta lista de preguntas se ha elaborado con la ayuda del grupo de apoyo para pacientes "Living with an ICD" <https://www.facebook.com/groups/>

El contenido de este documento solo tiene fines informativos y no pretende sustituir de ningún modo el asesoramiento médico, diagnóstico o tratamiento profesional. Nada de lo incluido en este documento debe interpretarse como promoción o solicitud para la indicación de ningún producto que no esté autorizado por las leyes y reglamentos de su país de residencia. Las respuestas a un tratamiento pueden variar de un paciente a otro. Consulte con su médico si tiene alguna pregunta o duda sobre su salud. Productos sanitarios con marcado CE conforme al Real Decreto 1616/2009.

Medtronic

Europa
Medtronic International Trading Sarl.
Route du Molliau 31
Case postale
CH-1131 Tolochenaz
www.medtronic.eu
Teléfono: +41 (0)21 802 70 00
Telefax: +41 (0)21 802 79 00

España
Medtronic Ibérica S.A.
Calle María de Portugal nº.11
ES-28050 Madrid
www.medtronic.es
Teléfono: +34 91 625 04 00
Telefax: +34 91 650 74 10

uc202103430a-icd-patient-guide-es-
emea-11774374 © 2024 Medtronic.
Todos los derechos reservados.
Impreso en Europa.