


Domande frequenti al medico curante

quando viene suggerito un dispositivo cardiaco (ICD o CRT-D)

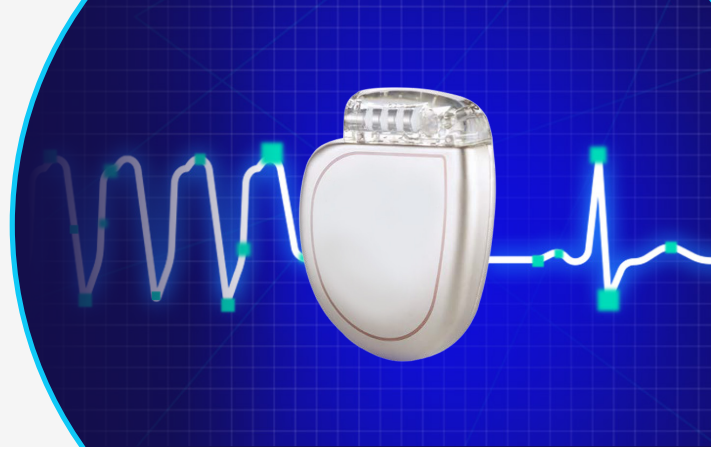


- Perché ho bisogno di un dispositivo cardiaco?
- Che alternative ho oltre a un impianto?
- I medicinali non sono in grado di aiutarmi?
- Come funziona questo dispositivo cardiaco?
- Dove verrà collocato?
- In che modo verrà impiantato?
 - Via intramuscolare o sottocutanea?
- Che aspetto avrà la cicatrice una volta rimarginata?
- Il dispositivo si sposterà dopo l'impianto?
- Che tipo di restrizioni dovrò osservare dopo l'impianto e per quanto tempo?
- Posso tornare a svolgere attività fisica dopo l'impianto e la convalescenza?
- Quando potrò tornare ad avere rapporti intimi con il partner?
- L'impianto condizionerà la mia carriera/i miei hobby?

Elencare eventuali funzioni lavorative o hobby che destano preoccupazione al proprio medico. Esempi: guidare un carrello elevatore o un camion per lavoro, lavorare nelle vicinanze di macchinari, hobby/attività quali nuoto, golf, tennis, caccia, saldatura e così via.
- Percepirò la presenza del dispositivo?
 - Sentirò la stimolazione?
 - Avvertirò lo shock?
 - Che sensazioni provoca lo shock?



Domande frequenti al medico curante

quando viene suggerito un dispositivo cardiaco (ICD o CRT-D)

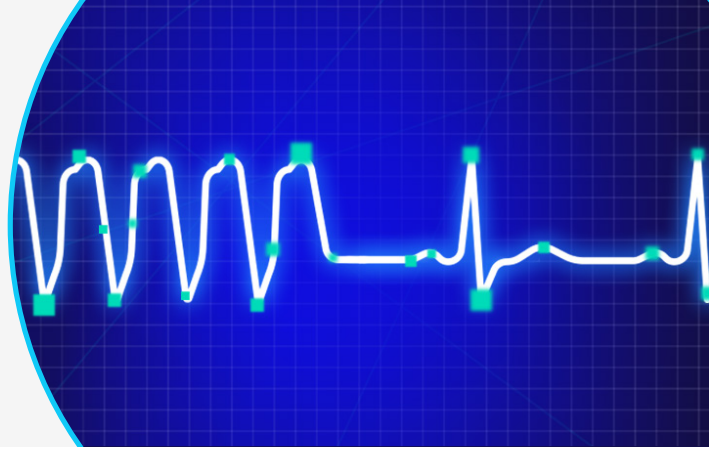

- Elaborare con il proprio medico un piano in caso di shock chiedendosi:**
 - Cosa devo fare se vengo sottoposto a scariche una volta?
 - E più volte?
 - Se qualcuno dovesse toccarmi durante lo shock potrebbe avvertirlo o farsi male?
- Devo chiamare il medico nel caso in cui dovessi cadere o urtare il dispositivo facendomi male?**
- Quanto durerà la batteria del dispositivo e come saprò se è il momento di cambiarla?**
- In futuro potrò essere sottoposto a risonanza magnetica?**
- Dopo l'intervento potrò recarmi in aeroporto e viaggiare tranquillamente in aereo?**
- Che tipo di elettrodomestici potrebbero interferire con il dispositivo e che tipo di precauzioni dovrei prendere?**
- Potrò trovarmi nelle vicinanze di magneti?**
 - Cosa accade nel momento in cui mi avvicino troppo a un magnete e il dispositivo emette un segnale acustico?
- È possibile ascoltare i diversi suoni che il dispositivo può emettere?**
 - Qual è il significato di ciascun suono?
 - Che comportamento devo adottare quando sento ciascuno di
- Sono idoneo al monitoraggio a distanza?**
- Come funziona il monitoraggio a distanza?**
 - Ci sono accorgimenti specifici da adottare o avviene tutto senza alcuna interazione da parte mia?
- Quali sono le risorse che ho a disposizione nel caso in cui dovessi avere ulteriori domande?**

L'elenco delle domande è stato elaborato con l'aiuto del gruppo di supporto per i pazienti "Living with an ICD" (Vivere con un ICD) <https://www.facebook.com/groups/icdsupport/>

Il contenuto di questo documento ha scopo puramente informativo e non intende sostituire in alcun modo consulenze, diagnosi o trattamenti medici professionali. Le informazioni contenute nel presente documento non sono da intendersi come una promozione o una sollecitazione di un'indicazione di prodotti non conformi alle leggi e alle normative del proprio paese di residenza. Le risposte a un trattamento possono variare in base al paziente. Per eventuali domande o dubbi sulla propria salute, consultare sempre il proprio medico curante.

Medtronic

Europa
Medtronic International Trading Sarl
Route du Molliau 31
Case postale
CH-1131 Tolochenaz
www.medtronic.eu
Tel: +41 (0) 21 802 70 00
Fax: +41 (0) 21 802 79 00

Italia
Medtronic Italia S.p.A.
Via Varesina, 162
IT- 20156 Milano (Mi)
www.medtronic.it
Tel. +39 02 24 13 71
Fax +39 02 24 13 81

Svizzera
Medtronic (Schweiz) AG
Talstrasse 9
Postfach 449
CH-3053 Münchenbuchsee
www.medtronic.ch
Tel. +41 (0)31 868 01 00
Fax +41 (0)31 868 01 99

uc202103430a-icd-patient-guide-it-emea-11774374
© 2024 Medtronic.
Tutti i diritti riservati.
Stampato in Europa.