


Perguntas que poderá querer fazer ao seu médico quando este lhe recomendar um dispositivo cardíaco (CDI ou CRT-D)




- Porque é que preciso de um dispositivo cardíaco?
- Que alternativas tenho além de implantar um dispositivo?
- Não é possível tratar o meu problema com medicação?
- Como é que este dispositivo cardíaco funciona?
- Onde é que o dispositivo será implantado?
- Como é que será implantado?
 - Debaixo da pele ou debaixo do músculo?
- Qual será o aspeto final da cicatriz?
- O dispositivo irá mover-se após o implante?
- Que restrições tenho de cumprir após o implante, e durante quanto tempo?
- Posso voltar a fazer exercício após o implante e após a recuperação?
- Quando é que eu e o/a meu/minha parceiro/a podemos voltar à intimidade?
- O implante afetará a minha carreira ou os meus passatempos?

(Anote funções do seu emprego ou atividades que o preocupem para depois falar com o seu médico. Exemplos: conduzir um empilhador ou camião no trabalho, trabalhar proximidade de maquinaria pesada, passatempos/ atividades como natação, golfe, ténis, caça, soldadura, etc.)
- Irei sentir o meu dispositivo a funcionar?
 - Irei sentir a estimulação?
 - Irei sentir um choque?
 - Qual é a sensação de um choque?

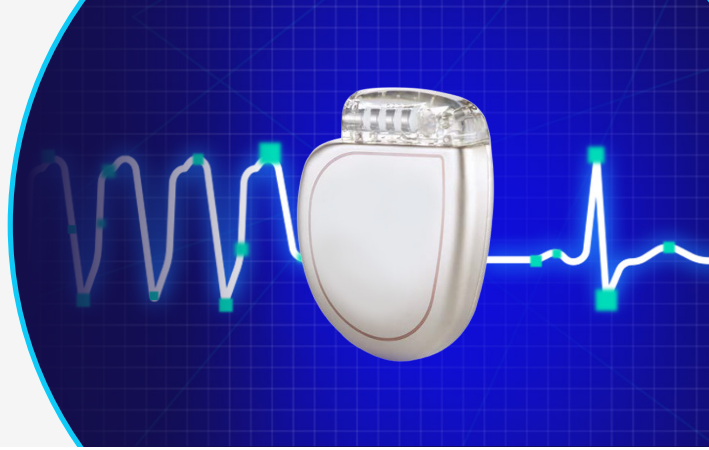

Perguntas que poderá querer fazer ao seu médico quando este lhe recomendar um dispositivo cardíaco (CDI ou CRT-D)

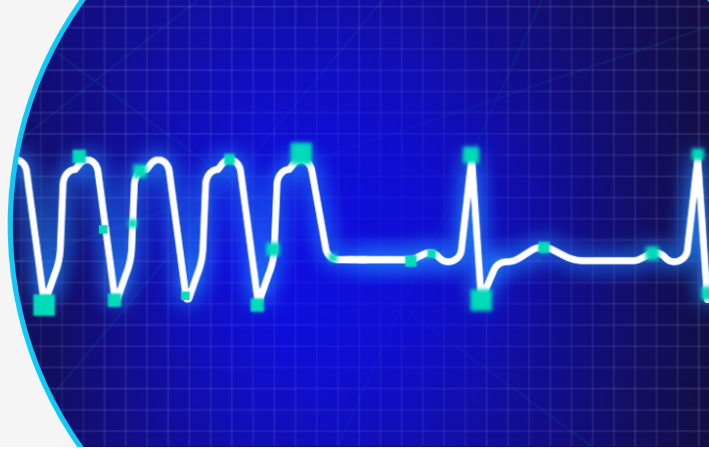

- Desenvolva um plano com o seu médico sobre como deve proceder após um choque, perguntando:**
 - O que devo fazer se receber um choque uma vez?
 - O que devo fazer se receber múltiplos choques?
 - Se alguém me tocar durante um choque, sentirá o choque ou ficará magoado?
- Preciso de contactar o hospital se cair ou bater dolorosamente com o meu dispositivo?**
- Quanto tempo durará a bateria do meu dispositivo e como saberei quando deve ser substituída?**
- Posso fazer uma ressonância magnética no futuro?**
- Posso viajar em segurança em aeroportos e aviões após a minha cirurgia?**
- Que tipo de aparelhos domésticos podem interferir com o meu dispositivo e que precauções devo tomar?**
- Posso estar perto de ímanes comuns?**
 - O que pode acontecer se me aproximar demasiado de um íman? O dispositivo implantado avisa dessa proximidade?
- O dispositivo implantado poderá emitir avisos sonoros?**
 - O que significam os diferentes sons?
 - O que devo fazer quando ouvir cada um dos sons?
- Sou um candidato à monitorização remota?**
- Como funciona a monitorização remota?**
 - Há algo de específico que tenha de fazer ou funciona sem a minha interação?
- Que recursos estão à minha disposição se tiver alguma pergunta adicional?**

Esta lista de perguntas foi desenvolvida com a ajuda do grupo de apoio a doentes
"Living with an ICD" <https://www.facebook.com/groups/icdsupport/>.

O conteúdo deste documento tem um cariz meramente informativo e não substitui, de modo algum, conselhos, diagnósticos ou tratamentos médicos profissionais. Nada no presente documento deve ser interpretado como uma promoção ou solicitação de indicação de qualquer produto, que não seja autorizada pelas leis e regulamentos do seu país de residência. As respostas a um tratamento podem variar de doente para doente. Consulte sempre o seu médico se tiver quaisquer questões ou preocupações sobre a sua saúde.

Medtronic

Europa
Medtronic International Trading Sarl.
Route du Molliau 31
Case postale
CH-1131 Tolochenaz
www.medtronic.eu
Tel: +41 (0) 21 802 70 00
Fax: +41 (0) 21 802 79 00

Portugal
Medtronic Portugal Lda
Torres de Lisboa
Rua Tomás da Fonseca, Torre E - 11º andar
PT-1600-209 Lisboa
www.medtronic.pt
Tel. +351 217 245 100
Fax +351 217 245 199

uc202103430a-icd-patient-guide-pt-emea-11774374 © 2024 Medtronic.
Todos os direitos reservados.
Impresso na Europa.

medtronic.eu